sasan
medical disposable products

Kod/*Code*: **STXXYYYZZZ**

www.sasan.com.tr

SASAN TAPERED TUBING

SASAN TAPERED ARTERIAL ADULT PUMP TUBING 3/8" 1/2" 3/8" 57 SHA

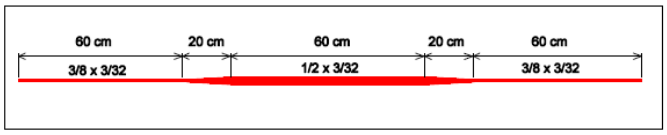

SASAN TAPERED ARTERIAL PEDIATRIC/INFANT PUMP TUBING 1/4" 3/8" 1/4" 57 SHA

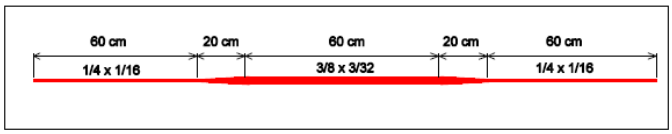

* İhtiyaç halinde yukarıdaki uzunluklar değiştirilebilir.

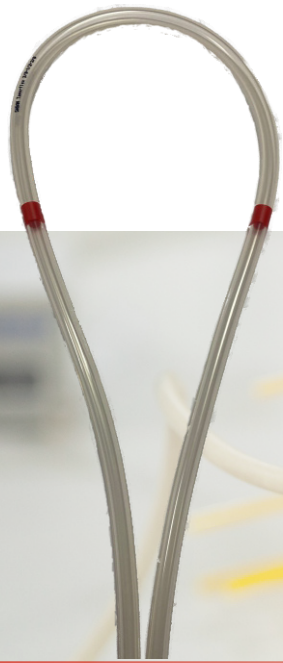

Kod/Code: *STXXYYYZZZ*
S: Sasan (Kodlama Başlangıcı) /*(Beginning of Code)*
T: TÜP/*TUBE*
XX: TÜP SHA KODU / *TUBE SHACODE*
YYY: TÜP ÖZEL KODU / *TUBE SPECIAL CODE*
ZZZ: TÜP UZUNLUK KODU / *TUBE LENGTH CODE*

SASAN TAPERED TUBING BÜYÜK VE KÜÇÜK ÇAPLAR ARASINDA KONNEKTÖR KULLANMADAN SADECE ARTER, SUCTION VE VENT HATLARI İÇİN ÖZEL ÜRETİLMİŞTİR

ÖZELLİKLERİ:

- Hemolizi Azaltır

Yapılan araştırmalarda sürekli pompalama yapıldıktan sonra Tapered Tubing teknolojili setlerde konnektörlü setlere oranla kanda %35'lik daha az hasar olduğu görülmüştür.

-Konnektörlerden kaynaklanan hataları ve riskleri (sızıntı, kopma) ortadan kaldırır (Bu sayede özellikle pulsatil akış sırasında daha fazla hasta güvenliği sağlar).

- Daha hassas kan teması sağladığından daha az hemoliz oluşur.

- Daha düşük RPM dönüşüne imkan verdiğinden daha az pompa başı ve tüp aşınmasını sağlar.

- Bu yeni hattın diğer tüpler ile aynı direnç, esneklik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olduğu, kan uyumluluğu sağladığı ve tüm standartları karşıladığı bilinmektedir.

- Sasan Tapered Tubing sadece pompa başında kullanılmak üzere özel granülden üretilmiştir.

- Roller pump kullanımında silikon tüpe göre daha az parçalanma; daha fazla pompa başı dayanıklılığı ve güvenilirliği sağlar.

- Sasan Tapered Tubing sürekli pompa testini başarıyla geçmiştir.

- Sasan Tapered Tubing, arter, suction ve vent pompa başları için farklı uzunluklarda, çaplarda ve duvar kalınlıklarında çeşitleri mevcuttur.

ÜRÜN İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARILAR

Sasan Tapered Tubing'in her bir parçasının pompa başı ve geçiş bölümleri, yukarıdaki şemada gösterildiği gibi kırmızı bantla işaretlenmiştir.

Uyarı: Sadece işaretli kısımlar arası pompa kanalına yerleştirilmelidir.

Uyarı: Geçiş bölümlerinin iç çapı değişkendir, bu nedenle geçiş bölümleri herhangi bir yere bağlanmamalıdır.